

リニューアル例

リニューアルする際、下記の工事が必要になります。

NBM、NAE-A、
NBM-Aから

ハンディナース対応
同時通話ナースコール
NBM-HP

ハンディナース対応
同時通話ナースコール
NBE-J


ハンディナース対応
同時通話ナースコール
NBE-SJ

ハンディナース対応
同時通話ナースコール
NBE

へのリニューアルの場合

配線の追加と
一部の機器を取り替えます。

《例:NBM-AをNBM-HPにリニューアル》

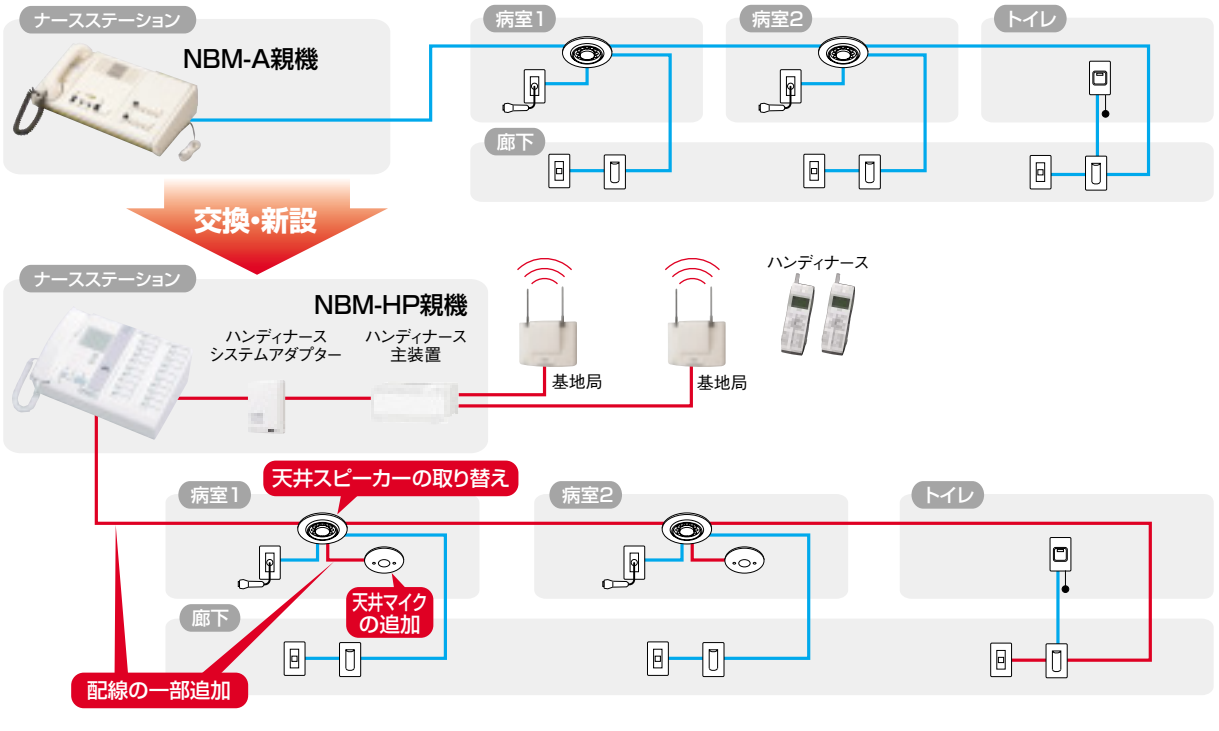

NBM-B、NAE-B、
NAE-B-SJ、NBXから

ハンディナース対応
同時通話ナースコール
NBM-HP

ハンディナース対応
同時通話ナースコール
NBE-J

ハンディナース対応
同時通話ナースコール
NBE-SJ

ハンディナース対応
同時通話ナースコール
NBE

へのリニューアルの場合

病室内工事不要

患者さんに迷惑をかけません。
配線及びナースコールはそのままご使用いただけます。

※配線の劣化等により一部工事が必要な場合があります。

《例:NAE-BをNBE-Jにリニューアル》

