

設計上のご注意


■ネットワーク設計

- ナースコールのネットワークは、単独のネットワークの構成として設計してください。病院内／施設内ネットワークと共用になる場合は、当社担当者までご相談ください。
- PoE対応L2スイッチとナースコール機器間の配線は、できるだけ上下フロアー間にまたがらないように設計してください。配線がフロアーをまたぐ場合は、各フロアーにPoE対応L2スイッチを設置し、PoE対応L2スイッチ間を接続してシステムを構築してください。その場合、PoE対応L2スイッチは2段までの設計としてください。

● ネットワーク設計例

大規模施設

(電子カルテ、オーダーリングシステム連動と、IP-PBX連動、ナースコールネットワーク内にネットワークプリンターがある場合)

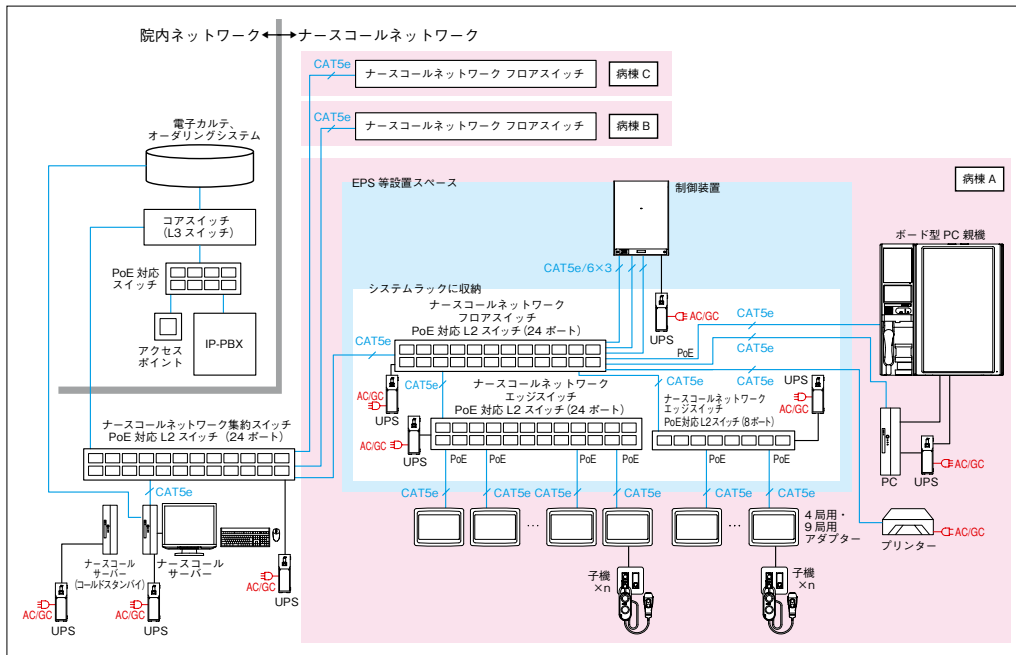

大規模施設(電子カルテ、オーダーリングシステム連動と、PBX連動がある場合)

