


システム構成例

ナースコールVi-nurse (4通話路システム) の例

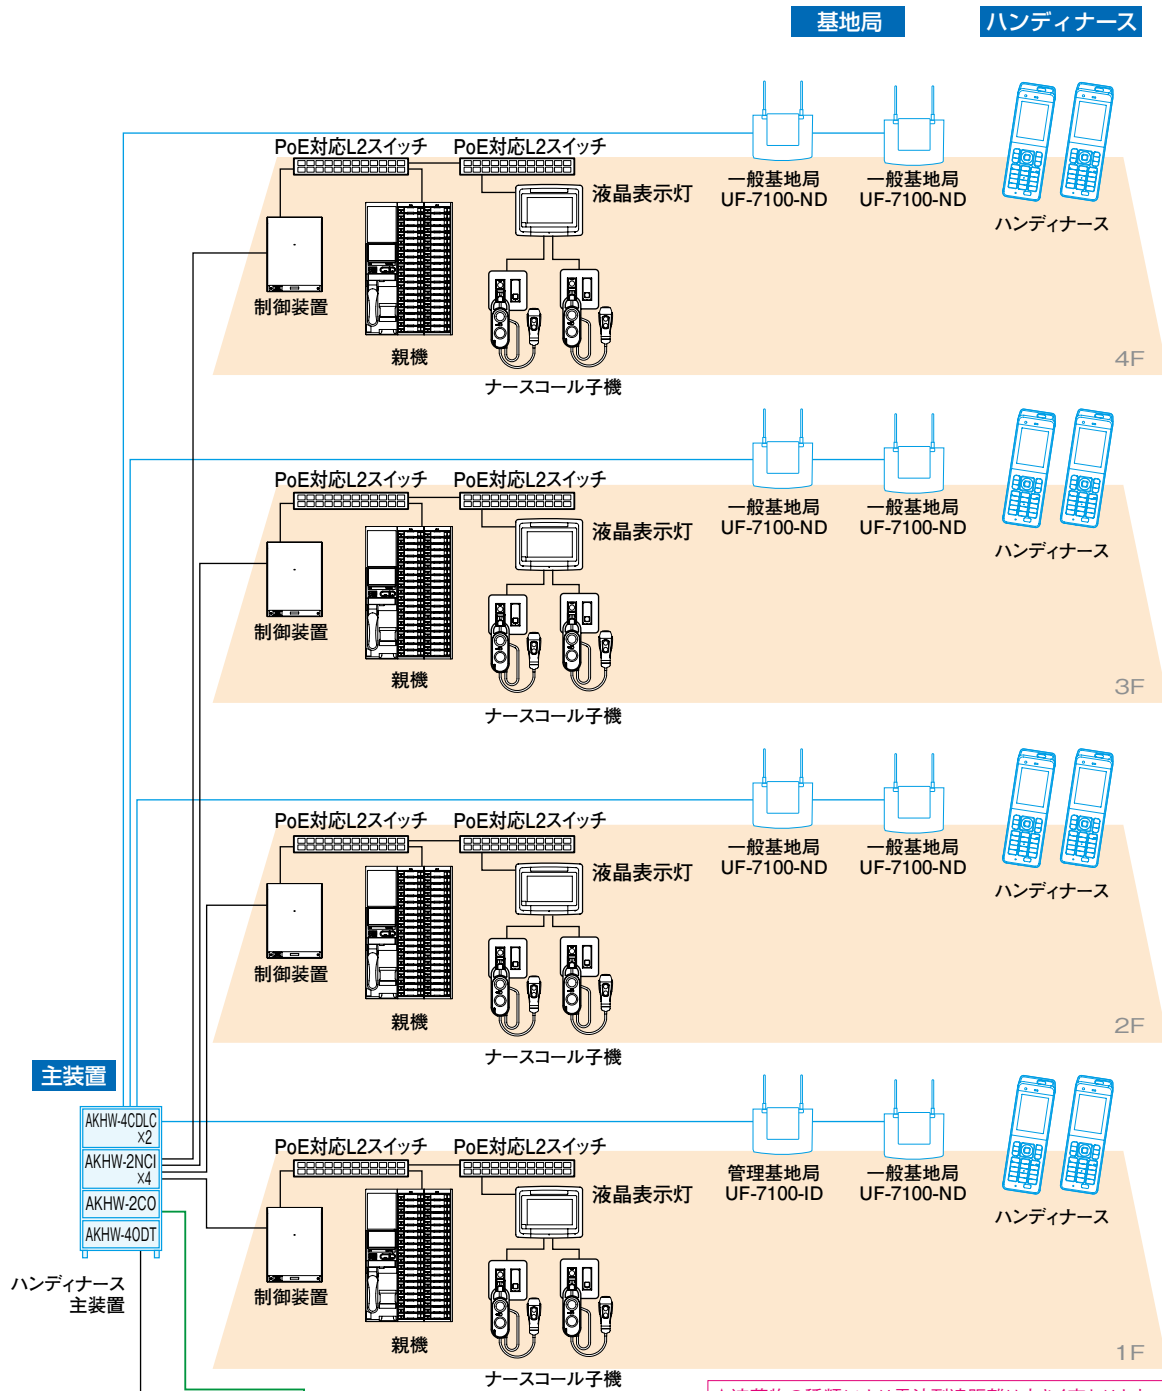

★遮蔽物の種類により電波到達距離は大きく変わります。
 ★設計後、実地測定による検証が必要です。
 ★この結果、基地局の追加が必要になる場合があります。

オプション(主装置にインターフェースパッケージの追加が必要です。)

☉ 外線
 外線接続用パッケージが必要です。

フロントPBX
 施設専用線用インターフェースパッケージが必要です。(AKH-L~3Lのみ収容可)

- 1 ナースコールシステム
- 2 コールセンター
- 3 ナースコールシステム
- 4 ナースコールシステム
- 5 ナースコールシステム
- 6 **ハンディナースシステム**
- 7 連絡システム
- 8 ナースコール
- 9 FOCUS
- 10 緊急通報装置
- 11 無線設備
- 12 無線設備