

8


ナースコールRenovest Renovest

● Renovest (リノベスト) とは? Renovation + Best = Renovest

アイホン株式会社が提案する「インターホン・リニューアル」の新しいカタチです。リノベストは、「リノベーション (改善)」と「ベスト (最良の)」を組み合わせた造語で、私たちの願いが込められています。安心、安全、快適な環境を実現し、皆さまの社会を豊かにいたします。

ナースコールシステムの製造時期一覧

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年

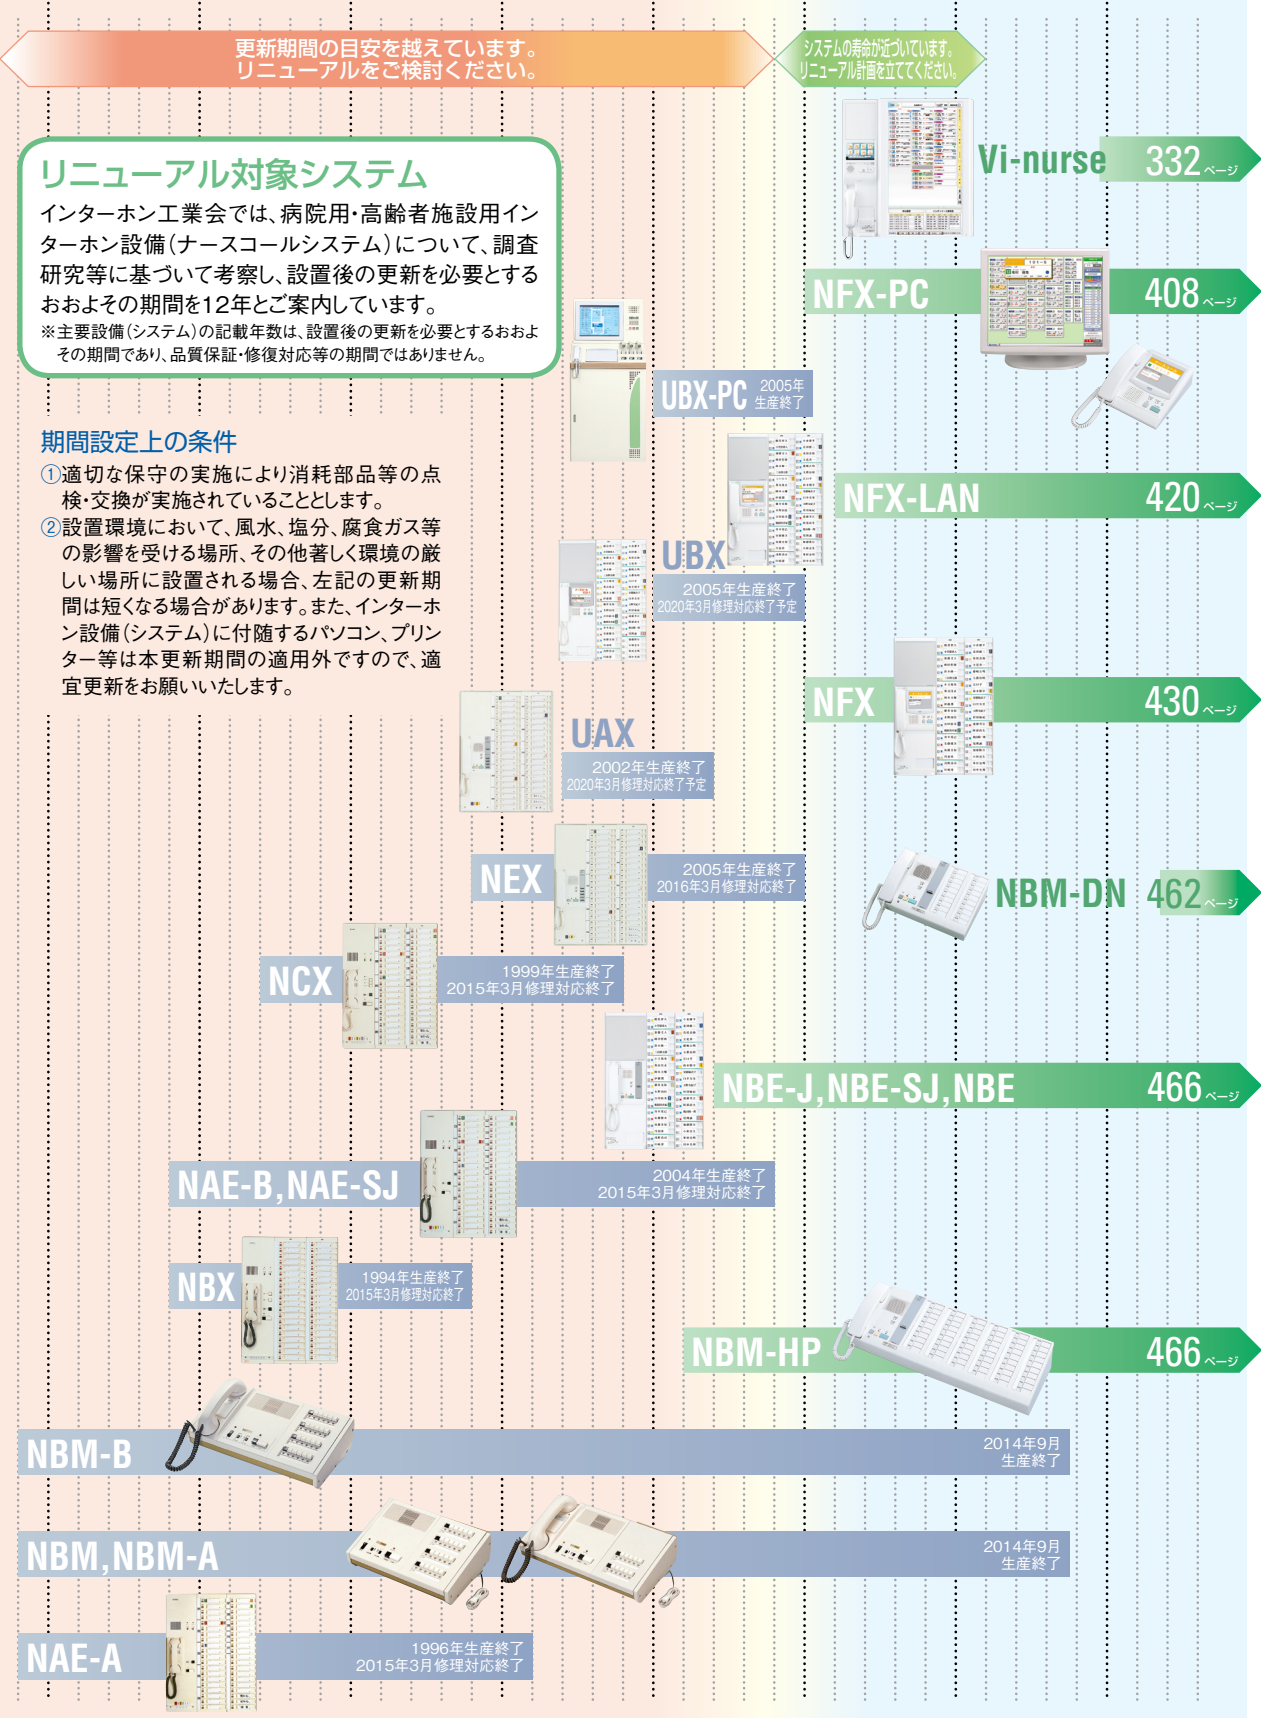

リニューアル対象システム

インターホン工業会では、病院用・高齢者施設用インターホン設備(ナースコールシステム)について、調査研究等に基づいて考察し、設置後の更新を必要とするおおよその期間を12年とご案内しています。

※主要設備(システム)の記載年数は、設置後の更新を必要とするおおよその期間であり、品質保証・修復対応等の期間ではありません。

期間設定上の条件

- ①適切な保守の実施により消耗部品等の点検・交換が実施されていることとします。
- ②設置環境において、風水、塩分、腐食ガス等の影響を受ける場所、その他著しく環境の厳しい場所に設置される場合、左記の更新期間は短くなる場合があります。また、インターホン設備(システム)に付随するパソコン、プリンター等は本更新期間の適用外ですので、適宜更新をお願いいたします。

更新期間の目安を越えています。リニューアルをご検討ください。

システムの寿命が近づいています。リニューアル計画を立ててください。

- 1 ナースコールシステム
- 2 Nurse
- 3 NFXシステム
- 4 個別式インターホン
- 5 マルチマークセンター
- 6 ハンディナースシステム
- 7 連絡システム
- 8 ナースコールRenovest
- 9 FACTS
- 10 緊急通報装置
- 11 介護業務支援システム
- 12 保のメンテナンス