


# リニューアル例

リニューアルする際、下記の工事が必要になります。

NBM、NAE-A、NBM-Aから **NBM-DN** **NBM-HP** **NBE-J** **NBE-SJ** **NBE** へのリニューアルの場合

配線の追加と一部の機器を取り替えます。

《例:NBM-AをNBM-HPにリニューアル》

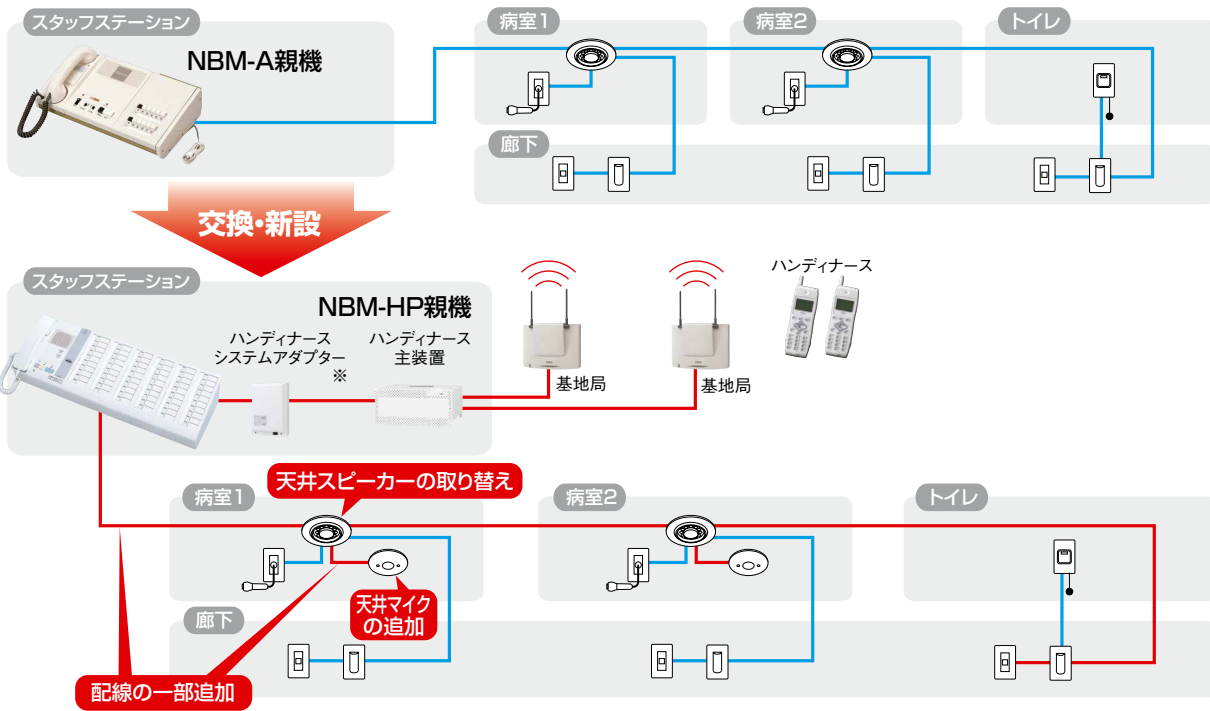

NBM-B、NAE-B、NAE-B-SJ、NBXから **NBM-DN** **NBM-HP** **NBE-J** **NBE-SJ** **NBE** へのリニューアルの場合

病室内工事不要

患者さんに迷惑をかけません。  
配線及びナースコールはそのままご使用いただけます。  
※配線の劣化等により一部工事が必要な場合があります。

《例:NAE-BをNBE-Jにリニューアル》

